

1

2

3

4

1. 样品名称

2. 样品来源

样品类型

有组织废气

检测项目

在线监测数据

1



Shanghai Test Co., Ltd

说 明

检测的准确性,公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所

样品和技术资料保密。

本报告涂改无效,于克梓以移权签字为无效,报告于本公司检验检测专用章骑缝

及无资质认定章  视为无效。

3. 本报告不准当面批准,不得命另复制或报告。

4. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测负责,不承担样品来源责任。

5. 对无法保存、复现的样品不予受理。

6. 本报告不得用于广告且传。

检测委托受理电话: 19979270001

检测服务技术支持电话: 15799862822

传真: 0792-8901066


E-mail: zhanhg_jxjh@163.com

中 以 14000

签发人职位:

授权签字人

(检验检测专用章)

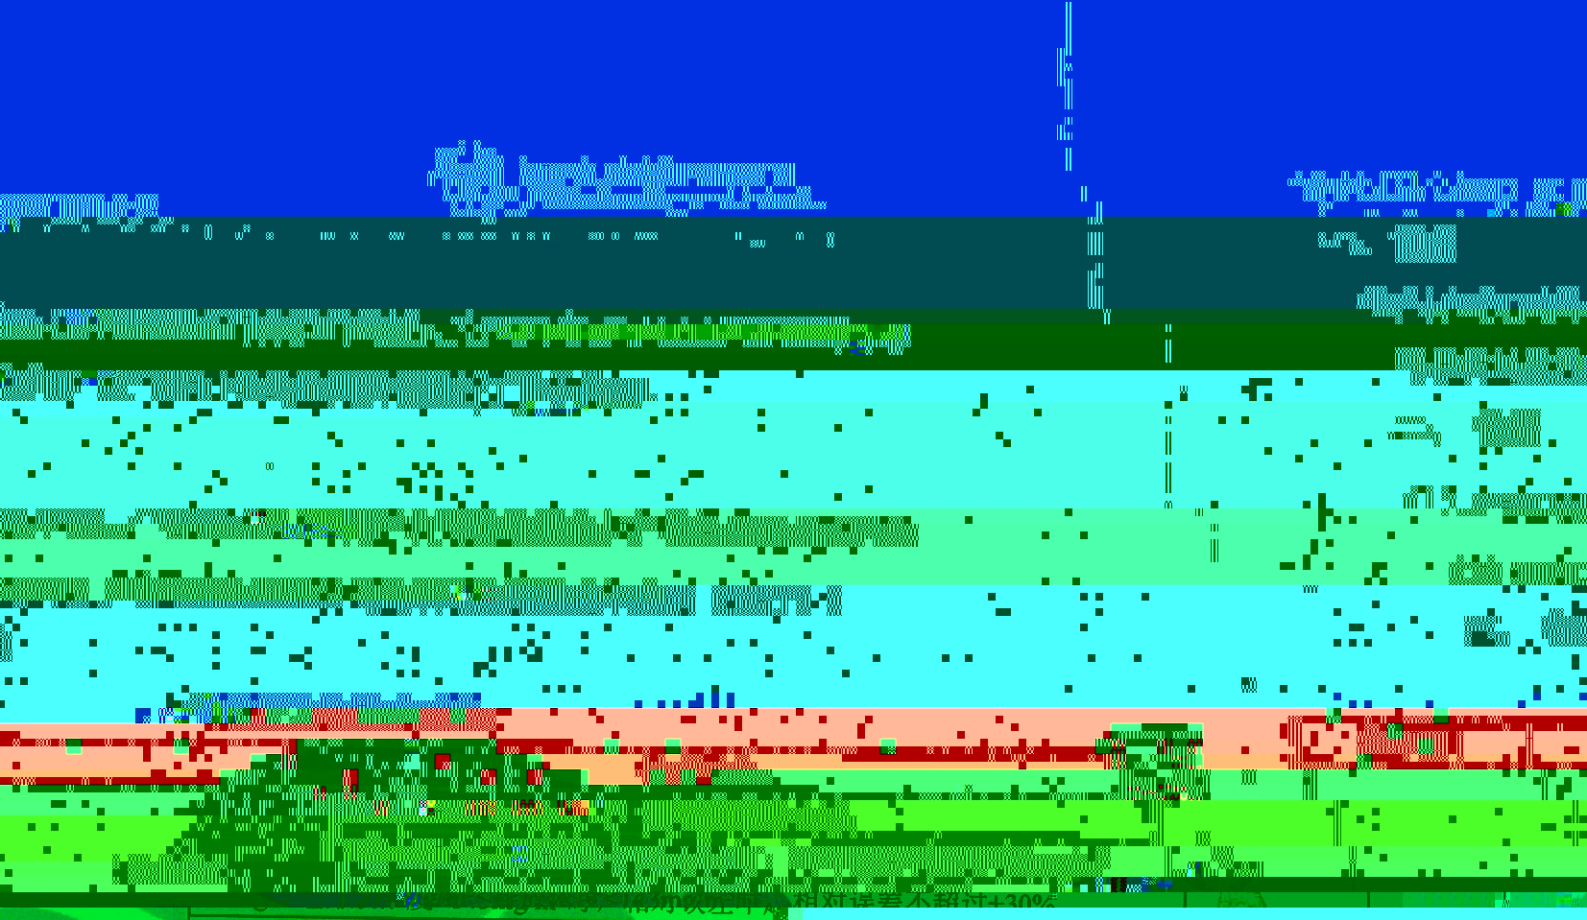

其他气体污染物		排放浓度 $\leq 41\text{mg/m}^3$ 时，绝对误差不超过 $\pm 12\text{mg/m}^3$ 相对准确度 $\leq 15\%$
颗粒物CMS	颗粒物	排放浓度 $\leq 100\text{mg/m}^3$ 时，绝对误差不超过 $\pm 25\%$ $20\text{mg/m}^3 < \text{排放浓度} \leq 50\text{mg/m}^3$ 时，绝对误差不超过 $\pm 30\%$ $10\text{mg/m}^3 < \text{排放浓度} \leq 20\text{mg/m}^3$ 时，绝对误差不超过 $\pm 6\text{mg/m}^3$ 排放浓度 $\leq 10\text{mg/m}^3$ 时，绝对误差不超过 $\pm 5\text{mg/m}^3$
流速CMS	流速	流速 $> 10\text{m/s}$ 时，相对误差不超过 $\pm 10\%$ 流速 $\leq 10\text{m/s}$ 时，相对误差不超过 $\pm 12\%$
温度CMS	温度	绝对误差不超过 $\pm 3^\circ\text{C}$
湿度CMS	湿度	相对湿度 $> 5.0\%$ 时，绝对误差不超过 $\pm 25\%$ 相对湿度 $\leq 5.0\%$ 时，绝对误差不超过 $\pm 1.5\%$

颗粒物分析仪	DMS-100	重量法	抚州泽天			
二氧化硫分析仪	EMSA	紫外差分吸收光谱	抚州泽天			
氮氧化物分析仪	EMSA	紫外差分吸收光谱	抚州泽天			
烟气流速	PT-500	差压法	抚州泽天			
烟气温度		铂电阻	抚州泽天			
项目	CEMS数值	参比方法值	单位	比对监测结果	依据	结果评定
二氧化硫	1002	17.8	mg/m ³	0.001	绝对误差不超过±1mg/m ³	达标
氮氧化物	168.028	146.3	mg/m ³	22	绝对误差不超过±41mg/m ³	达标
烟气温度	110.505	111.1	℃	0.31	绝对误差不超过±3℃	达标
含氧量	10.951	10.9	%	0.47	相对准确度≤15%	达标
湿度	21.28	21.53	%	-0.033	相对误差不超过±25%	达标
氯化氢	23.763	4.7	mg/m ³	19	/	
一氧化碳	0.087	0.3	%	-0.21		



1.03	107.751	149.4	第四次	140.440	140.5
第二次	36.651	3.5	第一次	0.103	0.2
第三次	15.247	3.6	第二次	0.137	0.1
第四次	31.914	3.3	第四次	0.092	0.4
第五次	10.145	3.4	第五次	0.108	1.0
第六次	17.917	3.4	第六次	0.092	0.0
平均值	23.763	3.7	平均值	0.087	0.3

