

拓谱思
Detection Technology

检测报告
Test Report

报告编号:
项目名称:
运维单位:

鄱阳县绿色
焚烧发电
有限公司

(检测)

LY2506113W

主能源公司鄱阳县生活垃圾
焚烧在线设备比对监测
拓谱思环保科技有限公司

印章

江西拓谱思
JIANGXI TOPS E

拓谱思环保科技有限公司
TOPS E TECHNOLOGY CO.,LTD.

报

- (1) 本
 - 任,
 - (2) 根
 - 量的
 - (3) 对
 - 理期
 - (4) 本
 - 本公司
 - 印佳
 - (5) 如
 - (6) 本
 - 置,
 - (7) 本
 - 和外
 - (8) 未
 - (9) 本
- 科学性、公
- 所提供的样品
- 求, 我们作
- 不为此承担
- 请及时向本
- 出之日起十
- 元复核、无审
- 、骑缝章及
- 元
- 求, 本公司报
- 责, 检测余样
- 的样品不受
- 次采样样
- 复现的样品
- , 不得部分
- 。

报告编号

项

项

委

联

电

报告

审

一、前言

鄱阳县绿色东方再
克麦哈克（北京）仪
器化氢、一氧化碳等。
限公司对鄱阳县绿色
控设备进行对比监测

二、依据

- (1) 《关于加强
【2019】64号；
- (2) 《固定污
染物排放总量控制指标
（2017）；
- (3) 《固定污
染物排放总量控制指标
其修改单；
- (4) 《固定污
染物排放总量控制指标
（2017）；
- (5) 《固定污
染物排放总量控制指标
（2017）；
- (6) 《固定污
染物排放总量控制指标
（2017）；
- (7) 《固定污
染物排放总量控制指标
（2017）；
- (8) 《固定污
染物排放总量控制指标
（2017）；

西省上饶市鄱阳县
在线监测颗粒物、
昌垒环保科技有限公司
县生活垃圾焚烧厂
成了本对比监测

村。CEMS系统由西
一氧化氮、二氧化硫、
西拓谱思、氧气、氯
污染源 CEMS 在线监

厂自动监控系统
、颗粒物）
与气体污染

作的通知》
环办执法
技术规范
》（HJ 75-
GB/T 16157
-1996）及
7）；
017）；
2014）；
018）；
/T 27-1999
）。

报告编号: TPSL

三、在线比

根据《关于
【2019】64号,》

检测项

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

一氧化碳


燃气温度

燃气湿度

燃气流速

含氧量


氯化氢

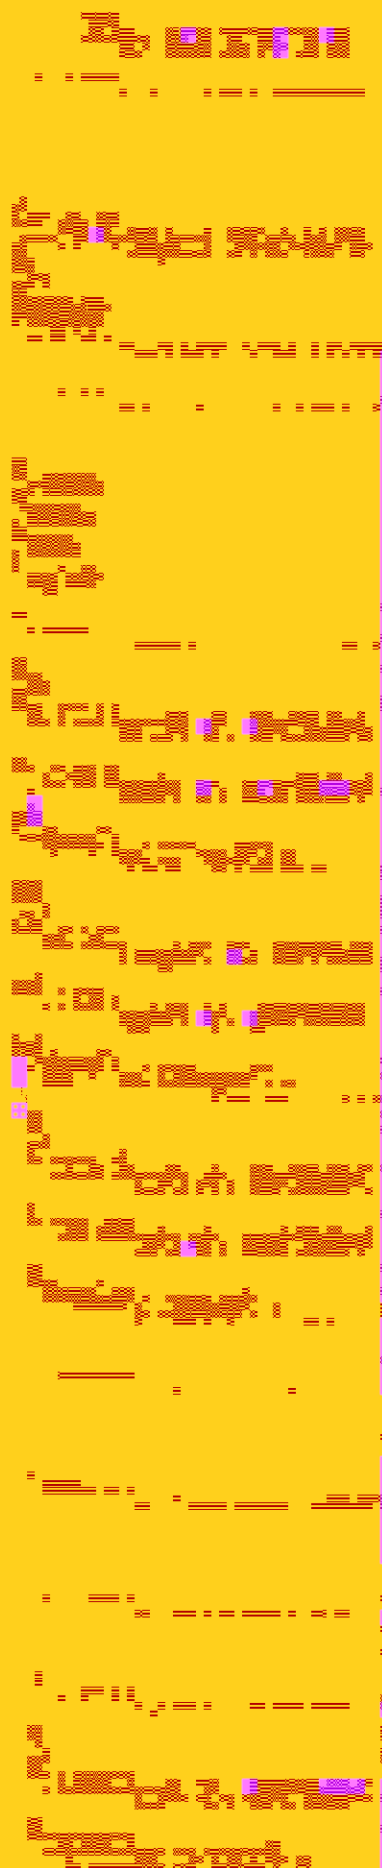


报告编号: TP

四、比对

测试点/位	44号料仓
仪器名称	CEMIS 在线颗粒物分析仪
项目	颗粒物
次数	1
时间	2023.12.20
参比方法	CEMIS 在线颗粒物分析仪
参比值	4.4
绝对误差	0.1
相对误差	2.3%
技术要求	绝对误差 ≤ 0.2, 相对误差 ≤ 5%
结果评定	合格
所用仪器名称	电子天平

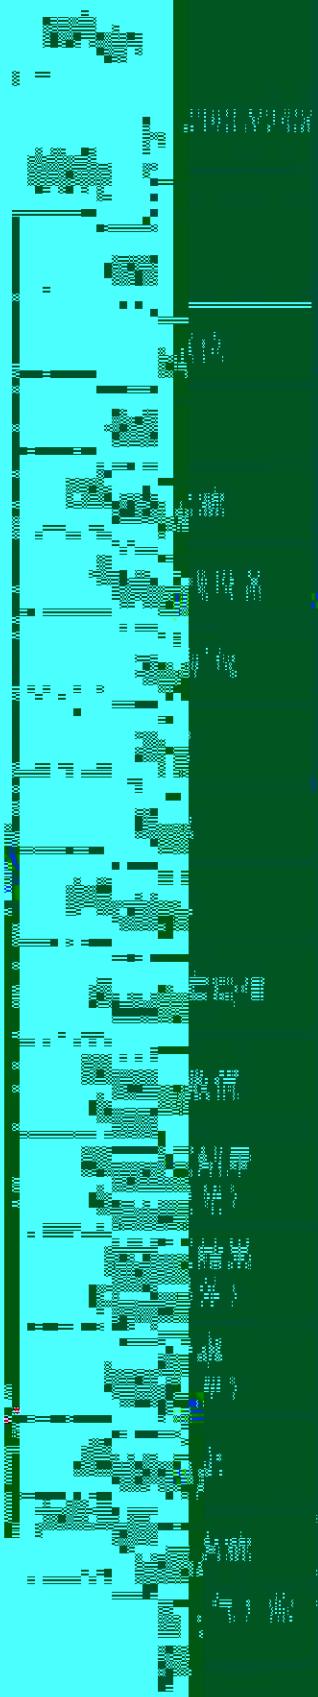

式()
散()
在()
电()
制()
类()
耐()
法()
的()
值()
的()
型()
制()
解()
的()
的()

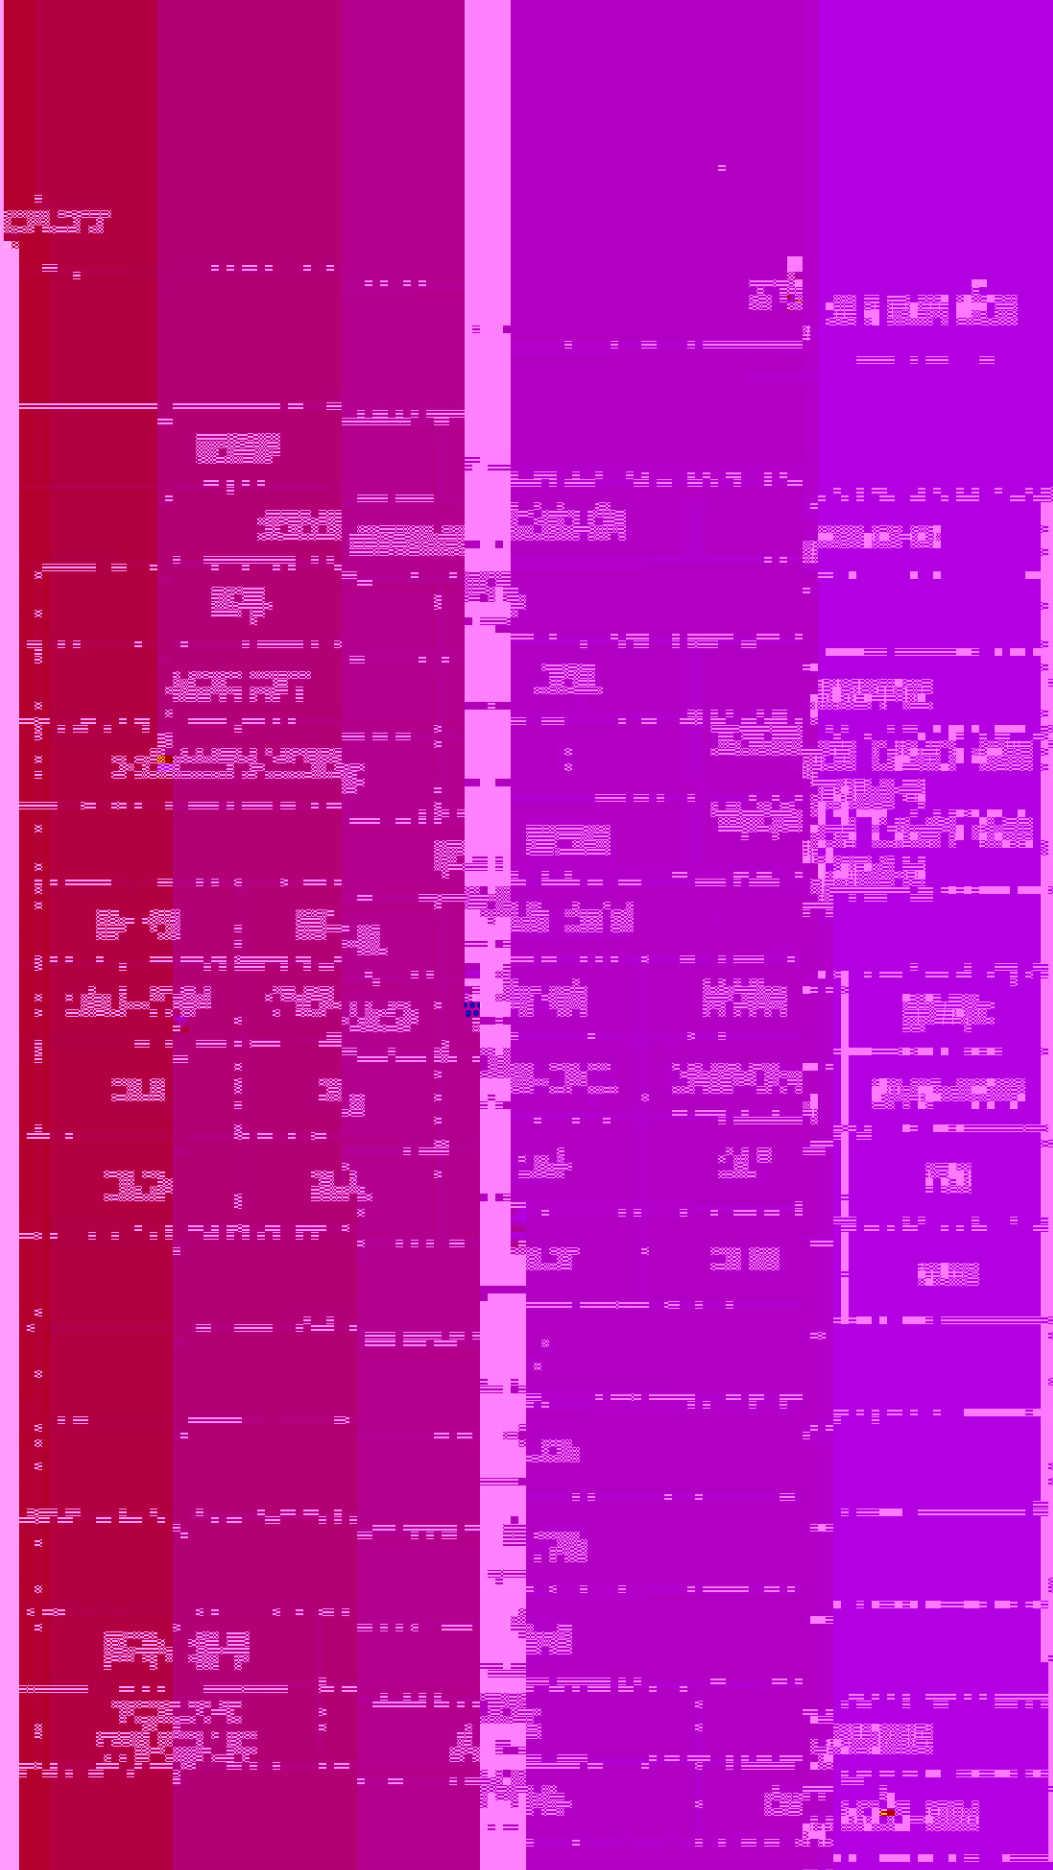

续表

测试点位	
仪器名称	
CEMS 在线设备	
压力传感器	
项目	
次数	第一
时间	16:55~17:00
参比方法实测值	-0.34
CEMS 数值	-0.33
比对监测结果 (绝对误差)	
比对监测结果 (相对误差)	
技术要求	
结果评定	
所用仪器名称	型号
大流量烟尘（气）测试仪	YQ3 TPS-

报告编号: TP6113W
SLY256

续表

测试点位	焚烧炉		
仪器名称	型号		
CEMS 在线设备	MCS 100F		
氯化氢分析仪	MCS 100F-111		
项目			
次数	第一次	第二次	第三次
时间	20:36~ 20:45	20:55~ 21:04	21:15~ 21:24
参比方法实测值	42.4	32.4	33
CEMS 数值	41.849	36.975	33.5
比对监测结果 (绝对误差)			
比对监测结果 (相对误差)			
技术要求 (绝对误差)			
结果评定			
所用仪器名称	型号、编号		
可见分光光度计	SP-72 TPS-YQ-19		

第 1

第 1

2025-06-09

建设单位

麦哈克（北京）仪器有限公司
麦哈克（北京）仪器有限公司

第八次 第九次

22:46~22:50 23:06~23:10

179 196

178.258 187.182

方法依据

HJ 693-2014

